



故障・動作不良への対応

- マノスター製品(計器)が正常に作動しない場合、動作不良の原因が計器の故障によるものか、圧力検知器または配管系に起因するものかを、下記の調査手順をご参考にユーザー様にてご確認ください。
- 確認の結果、計器の故障が明らか場合は、下記までご連絡ください。



- 代理店・取扱商社に返送されてきた製品に対する対応



故障・動作不良に関する連絡先

(株)マノスター販売


〒653-0031 神戸市長田区西尻池町一丁目2番3号
TEL.(078)621-7000 FAX.(078)621-7788

計器の定期校正

- 一般に計器の寿命・信頼性を長期間保持するためには、外部要因によるストレスをかけないことが重要です。計器は取扱説明書に従って適正に使用していただければ特に潤滑などの保守の必要はありませんが、1年に1回の定期校正をおすすめします。定期校正については代理店または弊社までお問い合わせください。
- 計器の状態によっては校正をお断りさせていただくことがございますので、予めご了承ください。

精度維持

弊社の圧力標準器の精度を維持するための校正システムを次に示します。

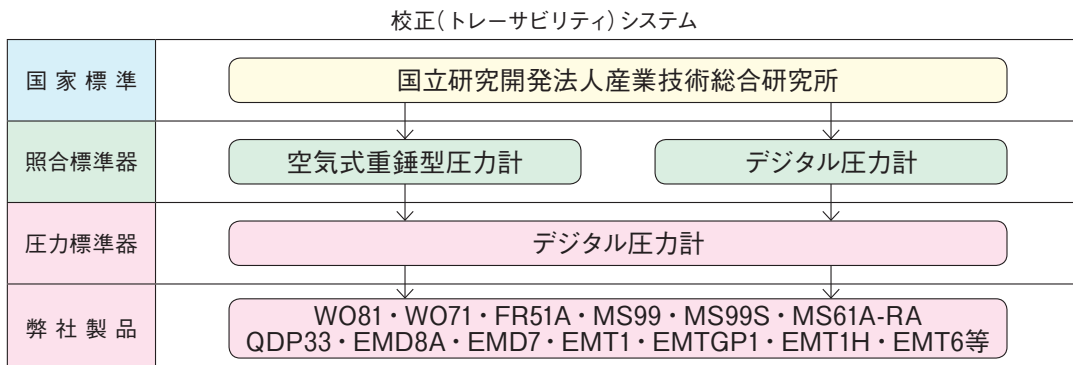

保守

保守

製品一覧表

WO81

校正サービスについて

- 弊社校正サービスでは製品の校正に加え、製品個々の状態に合わせて最適調整を行います。お客様へより良い状態でお返しすることにより、計器の精度および信頼性を維持するサービスをご提供いたします。
※校正サービスの対象は弊社製品に限ります。

WO71

FR51A

校正サービスの種類

- ・標準校正 : 計器の校正および最適調整を行います。
- ・スピード校正 : 計器の校正および最適調整を短納期で行います。(スピード校正は標準校正とは別に追加料金が必要です)

MS99

最適調整とは

校正結果が許容範囲外または許容範囲内であっても、弊社にて可能な限り真値に近くなるよう調整を行うことをいいます。
希望される場合 : 校正結果が保証精度範囲内外問わず最適調整を行います。(RoHS対応品のみ)
ただし、ご依頼製品が既に最適な状態である場合は最適調整を行いません。
希望されない場合 : 保証精度範囲内であれば最適調整を行いません。精度外だった場合にはご連絡させていただきます。

MS99S

MS61A-RA

発行書類について

最適調整実施 : 調整前データと調整後データの検査成績書(2通)を発行いたします。
最適調整未実施 : 校正データの検査成績書のみ発行いたします。
※校正証明書および標準器校正証明書は有償となります。なお、検査成績書につきましては校正サービスの料金に含まれています。

QDP33

EMD8A

その他

校正依頼品が校正不可の場合は、修理の可否もあわせてご連絡いたします。

EMD7

修理サービスについて

- 修理が必要な校正依頼品や修理依頼品を修理いたします。
※修理サービスの対象は弊社商品に限ります。
※RoHS非対応品は修理できません。

EMT1

発行書類について

修理を行った場合、修理後の検査成績書(1通)を発行いたします。

EMTGPI

その他

修理依頼品が修理不可の場合はご連絡いたします。

EMT1H

EMT6

EMP5A

EMRT1

HWS15A


アクセサリ

応用

注意事項

保守

〈ご依頼から返却までの流れ〉

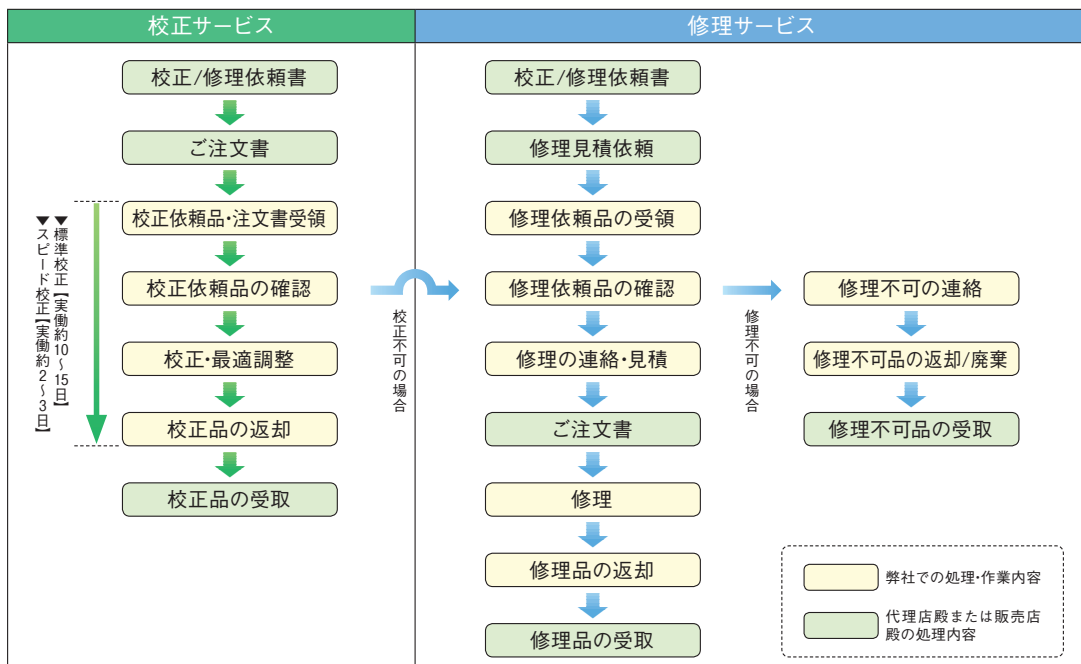

保証について

■保証期間

製品の保証期間は、弊社と直接取引のあるご注文主の指定場所に納入後1年といたします。

■保証範囲

上記保証期間中において弊社の責任による故障や瑕疵が明らかになった場合は、その製品の修理、または代替品の供給を無償にて行います。

ただし、保証期間内であっても、故障や瑕疵が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- (1) 取扱説明書、仕様書、弊社製品カタログなどに記載された以外の不当な条件、環境、取り扱い、使用方法による場合
- (2) 故障の原因が弊社製品以外の事由による場合
- (3) 弊社以外での改造、修理による場合
- (4) 弊社出荷時の科学、技術水準では予見が不可能だった事由による場合
- (5) その他、天災、災害など、弊社の責任ではない外部要因による場合

なお、ここでいう保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、製品の故障や瑕疵により誘発される損害は保証の対象外とさせていただきます。

※弊社製品保証は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

適用用途

弊社製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されています。

従いまして、下記のような用途での使用は意図しておりませんので適用外とさせていただきます。

- (1) 原子力発電、航空、鉄道、船舶、車両、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される設備
- (2) 電気、ガス、水道などの公共設備
- (3) 屋外での使用および、それに準ずる取扱説明書などで規定していない条件・環境での使用
- (4) 上記(1)および(2)に準じる安全に関して高度な配慮と注意が要求される用途

サービスについて

■サービスの範囲

製品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別個に費用を申し受けます。

- (1) 取付調整指導および試運転立会
- (2) 保守点検、調整および修理
- (3) 技術指導および技術教育
- (4) 製品の弊社工場における立会検査

《おことわり》本カタログに記載された製品の仕様および内容につきましては、改善等のため断りなしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●製品のご寿命は・・・

総代理店  株式会社 **マノスター販売**

〒653-0031 神戸市長田区西尻池町一丁目2番3号
TEL.(078)621-7000/FAX.(078)621-7788

製造元  株式会社 **山本電機製作所**

〒653-0031 神戸市長田区西尻池町一丁目2番3号
TEL.(078)631-6000/FAX.(078)631-6020